

保証書

株式会社 カスタム
印ス会

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - a 不適当な取扱い、使用による故障
 - b 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
 - c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - d その他当社の責任とみなされない故障

機種名	393-50	シリアル№	
保証期間	年 月 日より1ヵ年		
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

総合計測器メーカー

株式会社 カスタム

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

PHONE (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137

CUSTOM CORPORATION

6-12, 3-chome, Sotokanda,

Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN 101-0021

**HANDY SCALE
MODEL:393-50**

INSTRUCTION MANUAL

このたびは、「ハンディスケール」をお買い求めいただき、ありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しく使用して下さい。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本製品を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文中の **△**「危険」は、使用者が事故を起こす可能性を避けるための記号です。また **△**「警告」は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

△ 危険

- ・ご使用前に、約30秒のウォームアップを行ってください。
- ・急激な温度の変化のある場所に保存しないでください。
- ・精密機器のため、室内はできるだけ埃、チリのない清潔な環境でご使用ください。
- ・本製品の、使用する電池は「アルカリ電池」です。他の種類の電池では動作しませんので、注意してください。

△ 警告

- ・仕様をご参照いただき、最大測定重量を明らかに超えるものを計量することは、故障の原因になりますので、絶対におやめください。

△ 危険

- ・電池は、幼児の手の届かない場所で交換・保管してください。あやまって飲み込むおそれがあります。
- ・万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、使用済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。
- ・電池の交換のとき、濡れ手では行わないでください。さらに、スナッフは強く引っ張らないでください。

△ 警告

- ・フックは少しずつ緩んでくる場合がございます。ご使用前にフックが緩んでないか必ず確認してください。フック外れにつきましては保証の対象外となりますので十分注意してください。

△ 警告

- ・本器は、防水/防滴構造ではありません。水しぶき等のかかる場所、又は用途では故障の原因となりますので、十分に注意してください。この場合は保証の対象とはなりません。

CUSTOM CORPORATION

メンテナンスについて


- ・本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、アルコール、ベンジンなどの、揮発性の溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- ・不具合が生じた時は、弊社が弊社代理店にお問い合わせの上、必要な処置をとってください。
- ・弊社が委嘱した者以外が本体を分解した時は、保証の対象になりませんのでご注意ください。
- ・本体側部調整用ノブには絶対に触れないでください。

仕様


最大測定重量	50kg
最小目盛	0.05kg
表示単位	kg
風袋モード	"TARE"スイッチによる
表示	4桁LCD表示
オーバー表示	最大表示値の100%のとき"E"マークが点灯
ロー表示	"-"マークが点滅
ローバッテリー表示	"Lo"マークが点滅
オートパワーオフ	測定終了後約5分で自動的に電源がOFFになります。
使用電池	006P(9P)×1 アルカリ電池のみ使用可※
寸法・重量	125(H)×30(D)×90(W)mm、電池含む275g 全長ハンドルから手釣まで270mm
付属品	約1mのメジャー付

※電池は原則的に付属していません。一部テスト用電池が装着されている場合には早めに新品の電池と交換してください。

各部の名称と説明

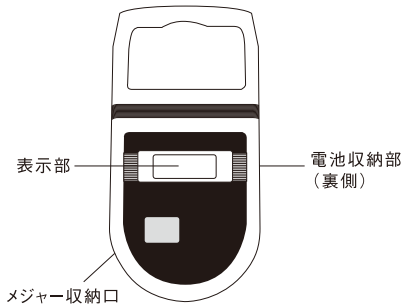

フロントパネルの説明

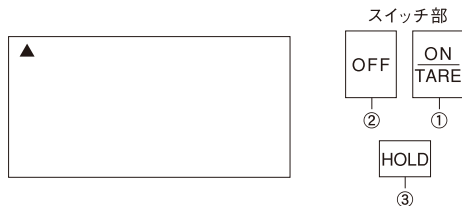

- ①ON/TARE
電源を入れるスイッチです。電源ONの時に押すと風袋モードになり"▲"マークが表示されます。
- ②OFFスイッチ
電源をOFFにするスイッチです。
- ③HOLDスイッチ
データを約5秒間ホールドするスイッチです。

使用方法

●はじめに

- ①本体裏側の電池カバーをスライドして電池ケースを開け、電池を装填します。
<電池の極性に注意してください。>
電池は"9V,006P型のアルカリ電池"を使用します。
上記以外の電池では動作しませんので注意してください。
- ②電池カバーを元に戻します。
- ③ON/TAREスイッチを押して電源を入れてから約30秒間ウォームアップをします。
- ④量る物をフックに引っ掛けて、又吊るすように軽量して下さい。
- ⑤表示が安定したら値を読みとって下さい。又、HOLDのスイッチを押すと約5秒間データがホールドします。
- ⑥計量が終了しましたら、すみやかに計量物を床におろし、フックをはずして下さい。